




米国 LECO 全機種 大巾値下げ!!

◆円切り上げを契機に、輸入販売方法を合理化……

従来のサービスセンターが直輸入を行い、一挙に価格の大巾切下げとサービス改善を図りました。ルツボその他消耗品も安くなりましたので詳細はお問い合わせください。

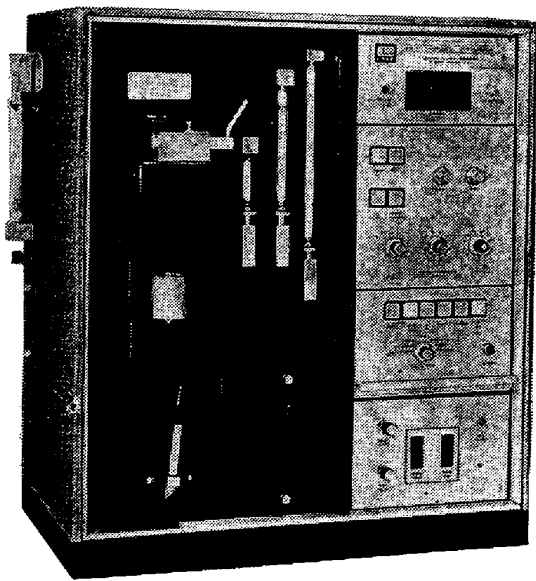


RH-1 水素分析装置

分析時間 2分
 分析範囲 0.1~100ppm
 精 度 ±3%
 サンプルサイズ 1~9g
 全自動直読式

CS-44 炭素硫黄同時分析装置

分析時間 1分
 分析範囲 炭素 0.005%~4%
 硫黄 0.0005%~0.2%
 精 度 炭素 ±1% 硫黄 ±3%
 全自動直読式

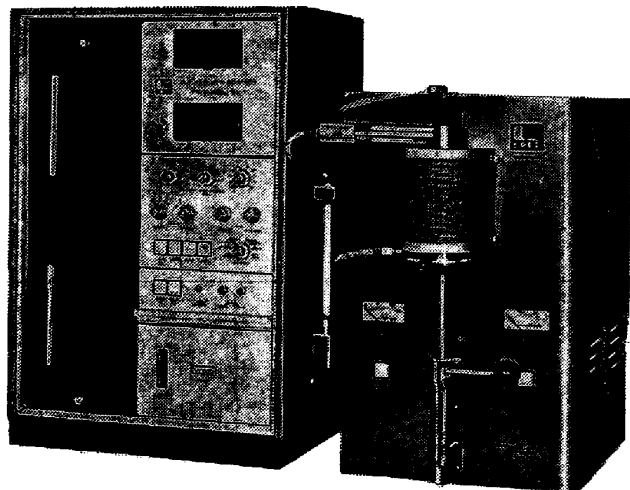

——— その他の製品 ———

IR-32自動硫黄分析装置 WR-12炭素分析装置 TN-14窒素分析装置
 RO-16酸素分析装置 TC-30酸素・窒素分析装置 70秒炭素分析装置 自動硫黄滴定装置

日本総代理店

日本アナリスト株式会社

東京都港区南青山2-22-1 (第5植松ビル) TEL(03)403-7944~6

昭和二十三年十月十一日
 昭和四十七年三月十五日
 印刷納本
 行本
 (毎月一回)
 印刷
 東京千代田区大手町一丁目五番地
 東京千代田区神田錦町二丁目七番
 戸田
 田畑
 新太郎
 行
 所
 東京千代田区大手町一丁目五番地
 東京千代田区大手町一丁目五番地
 電話
 振替
 口座
 東京
 一九三番
 (郵便番号一〇〇〇)
 分
 員
 料