平成四年九月二十五日印刷納本
平成四年十月一日発行（毎月一回一日発行）
編集兼発行人　東京都千代田区大手町一―九―四経団連会館内　島田仁
印刷人　東京都板橋区熊野町十三―十一　倉沢直則
〒一〇〇電話東京〇三（三二七九）六〇二一
郵便振替口座東京七―一九三番（会員の購読料は会費に含む）

LECO

金属・セラミックス中
酸素・窒素・アルゴン
分析装置

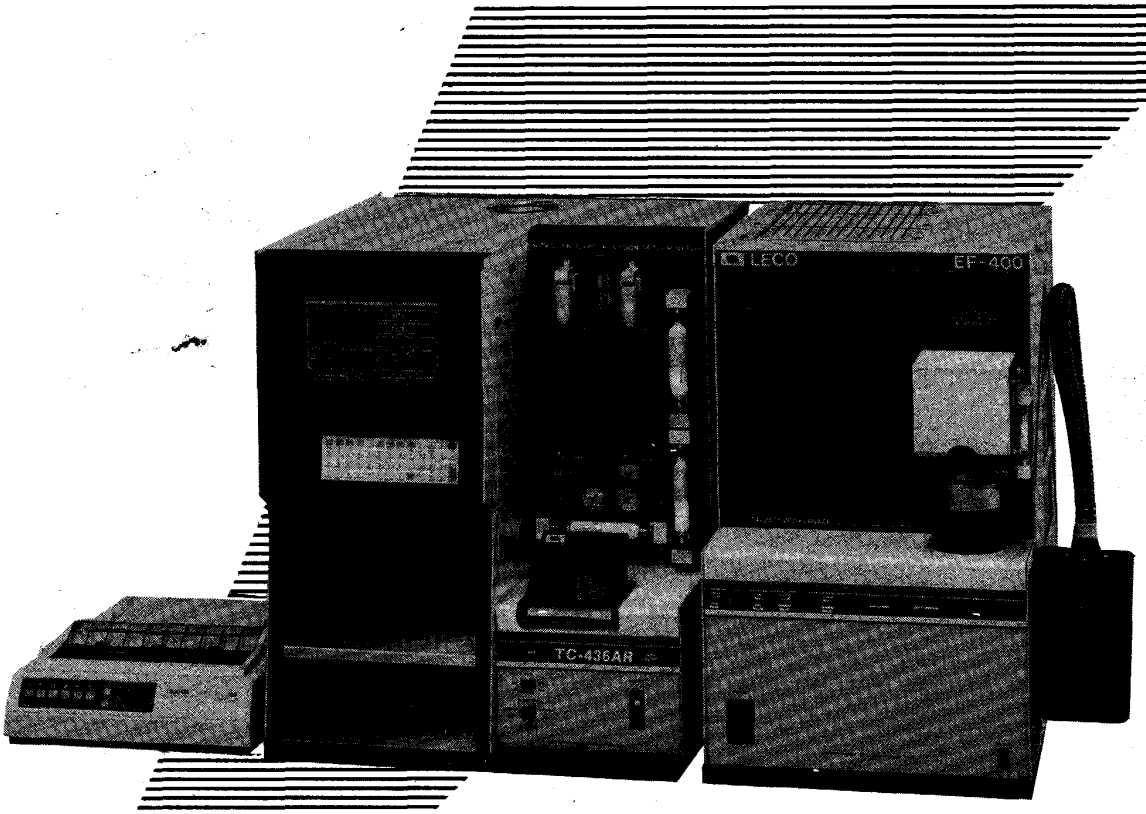

TC-436 AR型

AOD、VOD精錬では酸素／窒素のみならず、アルゴンの含有量を定量分析する事が重要です。
LECO TC-436AR型はO／N同時またはN／Arの同時分析が出来ます。切換も簡単で分析操作は、マイクロプロセッサーによる自動化で熟練を要しません。

分析感度：0.1ppm
分析所要時間：O／N同時分析　40秒
Ar分析　150秒

定評ある
品質とサービス

日本総代理店 **日本アナリスト株式会社**

本　社　〒141 東京都品川区西五反田3-8-8（町原ビル）　☎(03)3493-7281㈹
大阪支店　〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7（丹羽ビル）　☎(06) 849-7466
九州営業所　〒804 北九州市戸畑区汐井町1-1（戸畑ステーションビル）　☎(093)884-0309

カタログ贈呈